


2,450

9
6
41001

~~1709,9~~
17050

3/1(0,2)
5/ * 2

Z 13250
X R = 17013,0

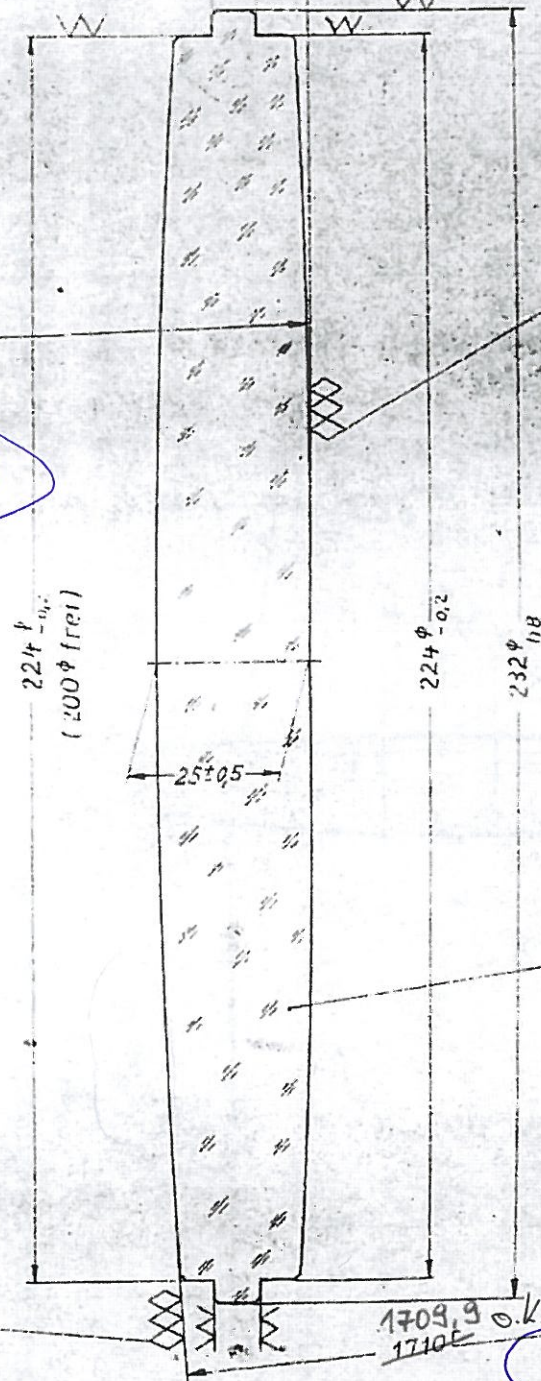

224 ± 0,2
(200 φ frei)

224 ± 0,2
232 ± 0,18

25 ± 0,5

1/ * 1
2/ 1

* 1 blasenfrei; Sonderabnahme für Einzelbläschen unter 0,10
* 2 Sonderabnahme

3/1(0,2)
5/ * 2

1709,9 o.k.
1710E

Z 12350
R = 1709,9

Schutzfasern 06 bis 08

		Okt. 57 Thiel	Abw. für Maße ohne Toleranz anzu-nehmen POL-2007-000	Halbzug Werkstoff -BK 7 N-BK 7	
		Okt. 57 Greulich		16 16 32 - 01(4)	
AZUZ	Tag	Name	Vergr. 1:1	Index 31	Benennung Objektiv für Koronagraph (f=3000)
Nr. d. A.	20.3.58	M. S. B.	Maßstab 1:1	Hersteller Astro	